

WYCENA DOTYCZĄCA ŚRODKA TECHNICZNEGO NR 36/XII/17

Dla: Powiatowy Szpital im. W. Bieganskiego

ul. Andersa 3

14-200 Iława

1. Dane dotyczące środka technicznego:

Nazwa		Typ		
System Ouantum do koblacji i kagulacji		RF 12000		
		Silniki		
Nr fabryczny	Rok budowy	Oznaczenie	Numer	Moc
B03554	2008	Nie dotyczy	-----	-----

2. Opis stanu technicznego: Stan techniczny maszyny określam jako dostateczny, wycofany z eksploatacji z bloku operacyjnego.

3 Stopień zużycia technicznego szacuję (S)= 50%


4 Wskaźnik nowoczesności konstrukcji przyjmuję (K= 0,8)

5. Współczynnik urynkowienia E=0,6

Nie wyszukałem żadnych ofert w internecie, zatem wartość określam metodą odtworzeniową wg formuły $C = W \times (1 - S) / (K \times E)$ W-w g. zleceniodawcy= **36281,11 zł** Zatem

$$C = 36281,11 \times (1 - 0,5) / (0,8 \times 0,6) = \mathbf{8707 \text{ zł po zaokrągleniu brutto}}$$

5. Na podstawie stanu technicznego określam wartość środka technicznego na kwotę: osiem tysięcy siedemset siedem zł

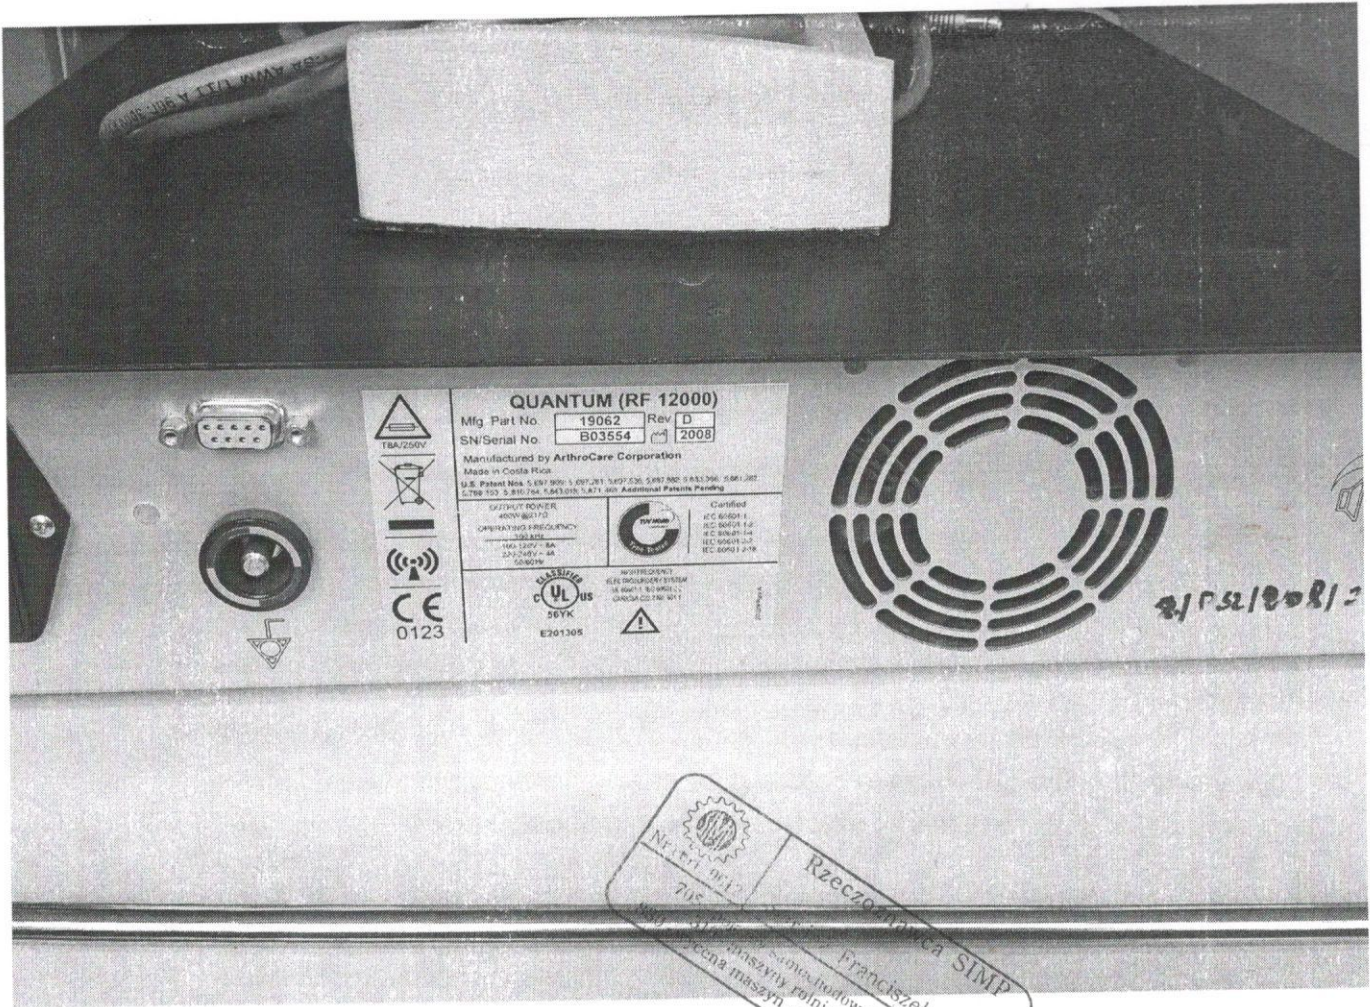

NEPTUN 705
Rzeszowska SIMP
Franciszek Górąj
Kliniczny gabinet i gabinet
specjalna maszyn, urządzeń i pojazdów

