

WYCENA DOTYCZĄCA ŚRODKA TECHNICZNEGO NR 11/VII/18

Dla: Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie

14-200 Iława ul. Gen. Andersa 3

1. Dane dotyczące środka technicznego:

Nazwa		Typ		
Cyfrowy aparat RTG z wyposażeniem jak w załączniku do arkusza wyceny firmy SIMENS za wyjątkiem pozycji 28,33,34,,35,36,37,38,39,40,41,4244,45,46,47,48		Telekomando DE R 200		
		Silniki		
Nr fabryczny	Rok budowy	Oznaczenie	Numer	Moc
05914244	2005	-----	-----	-----

2. Opis stanu technicznego: Stan techniczny urządzenia oceniam jako dostateczny, aparat intensywnie eksploatowany od ponad trzynastu lat, konstrukcja na dzień dzisiejszy przestarzała, użytkowany.

3 Stopień zużycia technicznego szacuję (S)= 70%

4 Wskaźnik nowoczesności konstrukcji przyjmuję (K= 0,4) ze względu na wiek

5. Współczynnik urynkowienia E określam na 0,35 z uwagi na bardzo ograniczony rynek potencjalnych nabywców

Na rynku wtórnym znalazłem jedną ofertę sprzedaży w Niemczech w załączeniu do opinii, zatem wartość określam metodą odtworzeniową wg formuły:


$$C = W / 1 - S / K \times E \text{ gdzie}$$

W-wartość początkowa wg informacji o zleceniodawcy wynosi netto 1284900 zł

$$\text{Zatem } C = 1284900 / 1 - 0,7 / \times 0,4 \times 0,35 = 53949 \text{ zł netto}$$

Na podstawie stanu technicznego określam wartość środka technicznego na kwotę:

pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć zł.






6. Uwagi, zastrzeżenia i ograniczenia





- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady materiału, uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzeniu oględzin.
- 2) Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na miesiąc sporządzenia wyceny.
- 3) Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści operatu i nie może być publikowane w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody sporządzającego i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
- 4) Rzeczoznawca nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności prawnej, a w szczególności odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- 5) Wykonawca operatu nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę operatu było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- 6) Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
- 7) Powyższa wycena wartości nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- 8) Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów, w tym ewentualnego ograniczenia praw własności.
- 9) W załączeniu zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym

Data 05.07.2018 r.

Pieczęć i podpis rzeczoznawcy





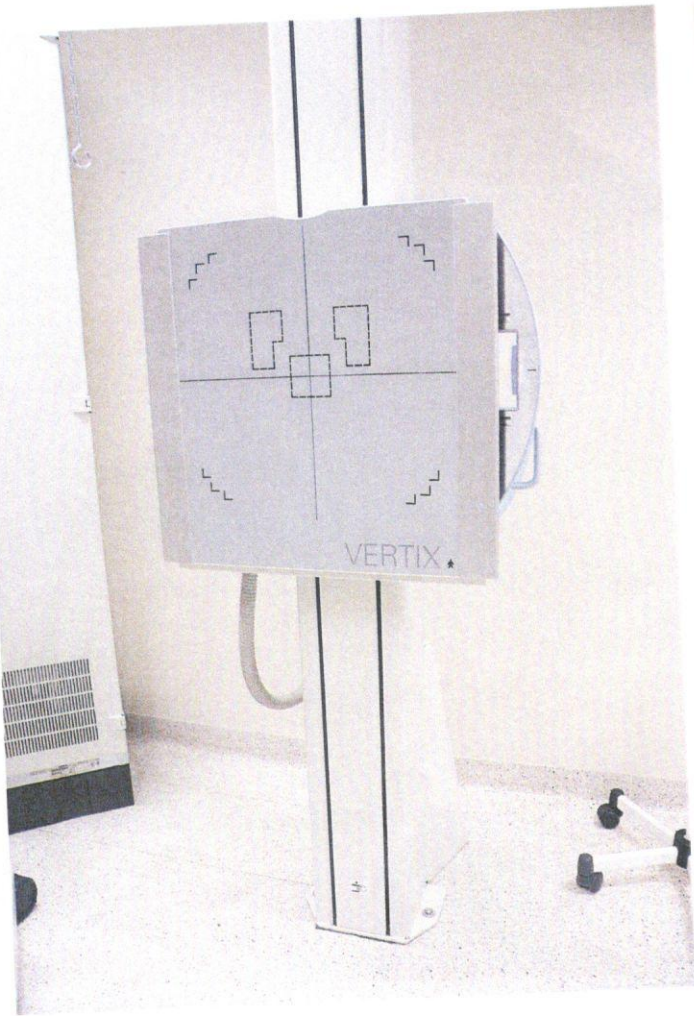

Poz. Opis

Ilość
Cena brutto
[PLN]

Cyfrowy aparat RTG telekomando typu AXIOM Iconos R200 z torem
cyfrowym typu FLUOROSPOT Compact

1	Ścianka aparatu AXIOM Iconos R200 ze statywem, zakres Trendelenburga 17°, generator RTG typu POLYDOROS SX 65, lampa RTG typu OPTITOP 150/40/80 HC-100 08861812	1
2	Urządzenie zdjęciowe, wzmacniacz obrazu 40 cm, wersja do radiografii cyfrowej (DR) z systemem FLUOROSPOT Compact, tor wizyjny typu Videomed DHC 14401967	1
3	Kolimator prostokątny i irysowy 04429721	1
4	Pedał do wyzwalania fluoroskopii i ekspozycji 04440967	1
5	Urządzenie do kompresji pacjenta 04429762	1
6	Konsola systemu Iconos R200 04429747	1
7	Funkcja fluoroskopii pulsacyjnej CAREVISION 04441676	1
8	Funkcja cyfrowej rejestracji sceny fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej FLUOROLOOP 04434077	1
9	Funkcjonalność sieciowa DICOM Query / Retrieve 04453838	1
10	Funkcjonalność sieciowa DICOM Worklist / MPPS 04434028	1
11	Funkcja kolimacji na obrazie zamrożonym bez promieniowania CAREPROFILE 04453846	1
12	Funkcja harmonizacji obrazu 04434051	1

✓ 13	Klawiatura systemu 04433616	1
✓ 14	Funkcjonalność sieciowa DICOM Print 04434093	1
✓ 15	Nagrywarka dysków CD-R w standardzie DICOM 04450339	1
✓ 16	Wózek z monitorem czarno-białym LCD-TFT 18" 04491192	1
✓ 17	Monochromatyczny monitor LCD-TFT 18" do sterowni 04491168	1
✓ 18	Automatyka formatowa (ACSS) statywu VERTIX Pro 04441593	1
✓ 19	Interfejs komunikacyjny statywu XCS 04483355	1
✓ 20	Statyw do zdjęć odległościowych VERTIX Pro 04415076 UB207	1
✓ 21	Kratka przeciwrozproszeniowa statywu Pb 13/70, f = 150 cm 04490392	1
✓ 22	Uchwyt do zawieszania bobiksów na statywie 08861325	1
✓ 23	Uchwyt do zawieszania bobiksów na ścianie 08861069	1
✓ 24	Uchwyty na nogi (lewy i prawy) 08860947	1
✓ 25	Bobiks typu U, 700 mm 08861143	1 1.535,27
✓ 26	Bobiks płaski, 700 mm 08861168	1 2.193,24
✓ 27	Instrukcja obsługi w języku polskim 14400120	1 Aparat RTG, poz. 1 – 24, 27 1.222.974,53

✓ 28	Bobiks typu U, 600 mm 04430187 GV035	1,454,32
✓ 29	Bobiks typu U, 1000 mm 04430211 GV035	1 1.978,81 ✓
✓ 30	Bobiks płaski, 800 mm 04430294 GV035	1 1.801,13 ✓
✓ 31	Rękawice ochronne MAVIG HS-215 / Pb 0,35 mm, para 05142273 Y0392	2 2 x 650,58 1301, ✓
✓ 32	Cyfrowa kamera dokumentacyjna w technologii suchej Agfa Drystar 5300 L0000001	1 57.997,57 ✓
33	Sieciowa kamera identyfikacyjna Agfa Digid 3000 L0000002	1 10.686,68 ✓
34	Kaseta RTG Agfa Curix z ekranem zielonoemitującym Curix Ortho Regular o czułości 400 z okienkiem typu amerykańskiego i rozmiarze 18 x 24 cm L0000003	6 6 x 625,10 3750, ✓
35	Kaseta RTG Agfa Curix z ekranem zielonoemitującym Curix Ortho Regular o czułości 400 z okienkiem typu amerykańskiego i rozmiarze 18 x 43 cm L0000004	6 6 x 844,11 5064,6 ✓
36	Kaseta RTG Agfa Curix z ekranem zielonoemitującym Curix Ortho Regular o czułości 400 z okienkiem typu amerykańskiego i rozmiarze 24 x 30 cm L0000005	6 6 x 792,38 4754, ✓
37	Kaseta RTG Agfa Curix z ekranem zielonoemitującym Curix Ortho Regular o czułości 400 z okienkiem typu amerykańskiego i rozmiarze 30 x 40 cm L0000006	6 6 x 1.065,31 6391, ✓
38	Kaseta RTG Agfa Curix z ekranem zielonoemitującym Curix Ortho Regular o czułości 400 z okienkiem typu amerykańskiego i rozmiarze 35 x 35 cm L0000007	6 6 x 1.082,92 6497, ✓
39	Kaseta RTG Agfa Curix z ekranem zielonoemitującym Curix Ortho Regular o czułości 400 z okienkiem typu amerykańskiego i rozmiarze 35 x 43 cm L0000008	9 9 x 1.235,52 11119, ✓
40	Majtki ochronne BHU BETA AGd Pb 1 mm, rozmiar S L0000009	1 673,64 ✓
41	Majtki ochronne BHU BETA AGd Pb 1 mm, rozmiar M L0000010	1 673,64 ✓

42	Majtki ochronne BHU BETA AGd Pb 1 mm, rozmiar L L0000011	1 673,64
✓ 43	Fartuch ochronny jednostronny komfort 0,35 mm, rozmiar 110 cm L0000012	2 2 x 816,53 4.033,0
44	Wywoływarka automatyczna Agfa Curix 60 L0000013	1 16.289,75
45	Sensytometr Pehamed Sensi C L0000014	1 4.390,34
46	Densytometr Pehamed Normscan L0000015	1 9.573,20
47	Termometr cyfrowy Amarell Electronic L0000016	1 375,54
48	Test przylegania folia / film Pehamed L0000017	1 1.048,28



dr inż. Grzegorz Postawka

SIEMENS Sp. z o.o.
MEDICAL SOLUTIONS
 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11
 Oddział w Gdyni
 81-366 Gdynia, ul. Batorego 28-32
 tel (58) 785-84-81, fax (58) 785-84-89

1396 892,01